
19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND





Offenlegungsschrift

28 23 291

Ø

Aktenzeichen:

P 28 23 291.9-35

Ø

Anmeldetag:

27. 5.78

€

Offenlegungstag:

29. 11. 79

3 Unionspriorität:

Ø 3 3

Bezeichnung:

Schaltung zur automatischen Einschaltung des Hochfrequenzstromes

von Hochfrequenz-Koagulationsgeräten

70

(3)

Anmelder:

Koch, Rainer, Ing.(grad.), 7800 Freiburg

(72)

Erfinder:

gleich Anmelder

Prüfungsantrag gem. § 28b PatG ist gestellt

Rainer Koch Mathildenstraße 20 7800 Freiburg

I.) Detentansprüche

Schaltung zur automatischen Einschaltung des Hochfrequenzstromes von Hochfrequenz-Koagulationsgeräten,

gekennzeichnet durch:

Zwei Zuleitungen (1,2), von denen die Zuleitung (1) mit dem Potentiometer (F1) verbunden ist, das mit seinem anderen Anschluß an dem Fotential von 9 V liegt, und von denen die Zuleitung (2) über den Widerstand (R2) an die Pasis des Transistors (T_1) führt. Von der Zuleitung (2) geht der Widerstand (R3) zur Mulleitung der Spannungsquelle. Die Basis des Transistors(T1) ist über den Kondensator(C1) geerdet. Der Follektor des Transistors (T_1) liegt über den Widerstand (R_1) an + 9 V. Der Cmitter des Transistors (T1) int geerdet. Der Vollektor des Transistors (T1) ist über das Potentiometer (P2) und den Widerstand (RA) mit der Basis des Transistors (T2) verbunden. Der Kollektoranschluß dieses Transistors führt über das Relais (Rel) und die Diode (D,), die beide perallelreschaltet sind, zum Kollektor des Transistors (T1) zurück. Der dmitter des Transistors (T_2) liegt auf + 9 V . Der Verbindungspunkt des Potentiometers (P2) und des Widerstandes (R4) ist über den Kondensator (C2) geerdet.

II.) Verwendung der Schaltung nach Anspruch I zum Schalten von Rochfrequenzströmen in HF-Koagulationsgeräten.

ORIGINAL INSPECTED

Scholtung zur automatischen Einschaltung des Hochfrequenzstromes von Hochfrequenz-Koagulationsgeräten.

Die Prfindung betrifft eine Schaltung des Hochfrequensstromes von Hochfrequenz-Koagulationsgeräten, die in der Chirurgie sum Verschließen von Blutgefäßen Verwendung finden (s.P. Bipolatoren) Bei den derzeit auf dem Markt befindlichen Geräten wird dabei der Koagulationsstrom stets durch mechanische Schalter eingeschaltet. Es handelt sich dabei entweder um Pußschalter oder um Schalter am Pinzettengriff.

Diese Art Schalter besitzen große Nachteile. Da der Yußschalter am Boden gelagert ist, muß er wie gesetzlich vorgeschrieben, explosionsgeschützt ausgeführt sein. Der Aufvand dafür ist erheblich, das Geröt verteuert sich, und die Bedienung führt, wie die Prexis gezeigt hat, besonders bei der Fußchalter-Ausführung zur Ermüdung des Betätigers. Der Nachteil des Schalters am Finzettengriff liegt darin, daß die FE-Einschaltung nur bei einem bestimmten Abstand der Pinzettenschenkel möglich ist. Gefäße verschiedener Stärke können deshalb nichtoptimal koaguliert werden. Ein weiterer Nachteil ist das erhöhte Gewicht der Pinzette, was die Handhabung besonders in der Mikrochirurgis erschwert. Ferner besteht die Gefahr der Kontaktoxidation.

Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsanordnung zu schaffen, die automatisch nach einer einstellbaren Verzögerung den Hochfrequensstrom bei Gewebekontakt der Pinzettenspitzen am gewünschten Punkt einschaltet. Die integrierte Verzögerungsschaltung verhindert ein Einschalten bei unbeabsichtigtem kurzem Gewebekontakt der Pinzettenspitzen oder bei kurzen Manipulationen im Gewebe.

Die Aufgabe wird durch die im Anspruch I angegebene Erfindung gelöst. Die erfindungsgemäße Schaltung besitzt den Vorteil, daß sie einfach und damit billig herstellbar ist und eine optimale Handhabung der Koagulationspingette gewährleistet.

Punktionsbeschreibung

Berühren die Pinzettenspitzen das zu verschließende Blutgefäß, so fließt über das Potentiometer (P_1) , durch das Gewebe und über den Widerstand (R_2) ein Basissteuerstrom, der den Darlingtontransistor (T_1) durchschaltet. Der maximale Gewebestrom beträgt dabei ca. 30 uA.

Der negative Spannungssprung am Kollektor des Transistors (T₁) wird erst nach einer entsprechenden Umladung des Kondensators (C₂) über das Fotentiometer (P₂) und den Widerstand (R₄) an der Basis des Transistors (T₂) wirksam. Dieser Transistor schaltet nun ebenfalls nach einer mittels des Potentiometers (F₂) einstellbaren Verzögerung durch, und es fließt so lange Strom durch das Relais (Rel) wie der Transistor (T₁) infolge Gewebekontakt der Finzettenspitzen durchgeschaltet ist. Wird die Pinzette aus dem Tewebe entfernt, so sperrt augenblicklich der Transistor (T₁) und das Relais (Rel) fällt ab, obwohl der Transistor (T₂) noch bis zur erneuten Umladung des Kondensators (C₂) durchgeschaltet ist. Las Relais (Rel) schaltet über seine zugehörigen Kontakte den HF-Koagulator nur dann ein, wenn beide Transistoren durchgeschaltet sind, d.h. wenn die linzettenspitzen Gewebekontakt haben und eine einstellbare Verzögerungszeit abgelaufen ist.(UND-Funktion)

Die Widerstände $(R_2u_*R_3)$ sowie der Kondensator (C_1) begrenzen den HF-Strom bei eingeschalteten Kongulator, der als Basisstrom den Transisters (T_1) susätzlich wirksam wird und verhindern einen "Helteeffekt" der Schaltung bei unterbrochenem Gewebekontakt der Pinzettenspitzen. Die Diode (D_1) schützt den Transistor (T_2) vor induktiven Ausschaltspannungsspitzen.

In einer bevoreugten Ausbildungsform ist die Schaltung wie folgt dimensioniert :

```
R<sub>1</sub> = 2,2 KOhm P<sub>1</sub> = 500 KOhm T<sub>1</sub> = BC 517 Darlington

R<sub>2</sub> = 47 KOhm P<sub>2</sub> = 100 KOhm T<sub>2</sub> = BC 251

R<sub>3</sub> = 47 KOhm C<sub>1</sub> = 1 uF Rel = 8 V / 40 mA 1xEin

R<sub>4</sub> = 2,2 KOhm C<sub>2</sub> = 100 uF D<sub>1</sub> = 1 N 4148
```

Leerseite

-5-

Nummer: int. CL²:

Anmeldetag:
Offenlegungstag:


28 23 291 A 61 B 17/36

27. Mai 1978

29. November 1979

2823291

HF-Koagulator (bi-oder unipolar)

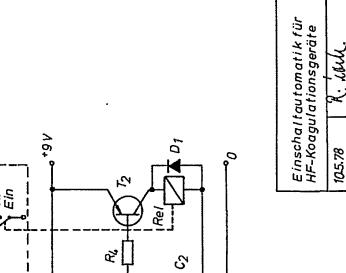

£

Pinzettenspitzen --

ORIGINAL INSPECTED

909848/0460

DE 28 23 291 A1

51 International Classification A 61 B 17/36

19 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

GERMAN PATENT OFFICE

11 Publication Document 28 23 291

21 Reference: P 28 23 291.9-35

22 Application Date: 5/27/78

43 Publication date: 11/29/79

30 Union Priority: 32 33 31

54 Title: Circuit for automatic power-up of high-frequency current in high-frequency coagulators

71 Applicant: Koch, Rainer, Engineering graduate student, 7800 Freiburg, Germany

72 Inventor: Same as Applicant

Testing application per § 28b PatG¹ has been submitted.

¹ Translator's Note: PatG = Patentgesetz = German Patent Law

Rainer Koch Mathildenstraße 20 7800 Freiburg, Germany

Patent Claim 1:

Circuit for automatic power-up of high-frequency current in high-frequency coagulators,

characterized by

two supply lines (1, 2) of which the supply line (1) is connected to the potentiometer (P_1) whose other connection receives a potential of 9V, of which the supply line (2) is connected to the base of the transistor (T_1) via the resistance (R_2) . The resistance (R_3) is connected from the supply line (2) to the null line of the voltage source. The base of the transistor (T_1) is grounded via the capacitor (C_1) . The collector of the transistor (T_1) is connected to +9V via the resistance (R_1) . The emitter of the transistor (T_1) is grounded. The collector of the transistor (T_1) is connected to the base of the transistor (T_2) via the potentiometer (P_2) and the resistance (R_4) . The collector connected in parallel) back to the collector of the transistor (T_1) . The emitter of the transistor (T_2) is connected to +9V. The connection point of the potentiometer (P_2) and of the resistance (R_4) is grounded via the capacitor (C_2) .